MET VAMOS Механо

Кровать медицинская функциональная трехсекционная с винтовым приводом

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	стр. 2
1.1.	Поставка	стр. 3
1.2.	Перемещение кровати	стр. 3
2.	Технические характеристики	стр. 3
3.	Правила безопасности	стр. 3
4.	Кровать в деталях	стр. 4
5.	Установка кровати	стр. 5
6.	Положения кровати	стр. 5
7.	Спинки кровати и штанга двухопорная (рама Балканского)	стр. 5
8.	Колеса	стр. 5
9.	Боковые ограждения	стр. 6
10.	Очистка и дезинфекция	стр. 6
11.	Техническое обслуживание	стр. 7
12.	Комплект поставки	стр. 7
13.	Гарантийные обязательства	стр. 8

1. Введение

Данная модель кровати предназначена для использования в медицинских учреждениях и в домашних условиях.
Кровать изготавливается в соответствии с международными стандартами.

	Чтобы правильно использовать данную кровать, внимательно прочитайте руководство пользователя перед ее использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашей кровати.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании кровати важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.

1.1. Поставка

Наши кровати поставляются полностью смонтированными или разобранными на несколько частей. Перед использованием изделия вся кровать должна быть полностью собрана.
Если в комплектации кровати отсутствуют какие-либо детали или обнаружены повреждения, Вы должны немедленно письменно известить производителя / поставщика.

1.2. Перемещение кровати

Колеса кровати не должны быть заблокированы во время перемещений. Колеса предназначены для использования в закрытых помещениях и должны перемещаться по гладкой и чистой поверхности. Перемещения по неровному или загрязненному полу могут привести к повреждению колес.


2. Технические характеристики

Габариты кровати	212*96 см
Габариты ложа	198-83 см
Угол наклона спинной секции	0® - 65®
Максимальная распределенная рабочая нагрузка	150 кг

3. Правила безопасности

- Перед использованием кровати внимательно прочитайте руководство пользователя.
- Если в кровати обнаружены неисправности или повреждения, не используйте ее и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Если Вы не планируете перемещать кровать, ее колеса должны быть заблокированы, чтобы минимизировать риск травмы пациента.
- Недопустимо создавать дополнительную нагрузку на кровать во время нахождения на ней пациента – например, сидение на ней еще одного человека недопустимо.
- При использовании функций кровати не допускайте зажимания ее элементами пациента или других лиц.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.
- Если кровать перемещается вместе с пациентом, ограждения должны быть подняты и зафиксированы.

4. Кровать в деталях

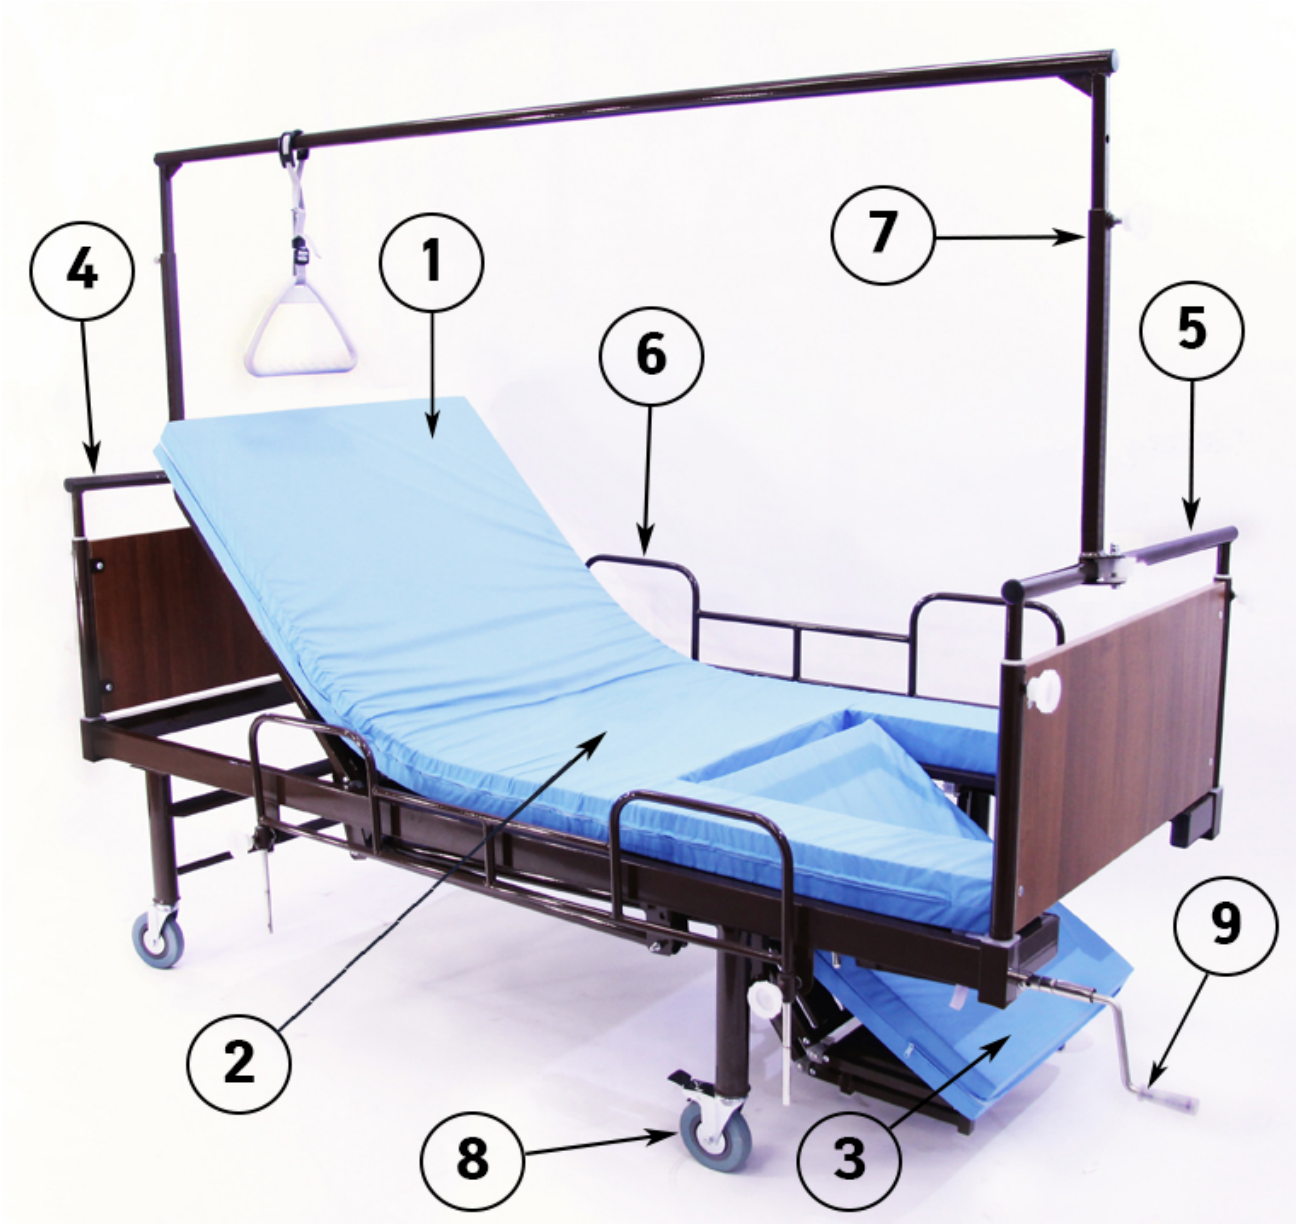

1. Головная секция ложа
2. Бедренная секция ложа
3. Икроножная секция ложа
4. Головная спинка
5. Ножная спинка
6. Боковые ограждения
7. Штанга двухопорная (рама Балканского) с ручкой для подтягивания
8. Колеса
9. Рычаг механического привода

⚠	Перед перемещением кровати всегда проверяйте колеса и, если колеса заблокированы, разблокируйте их.

⚠	Если во время установки обнаружены какие-либо неисправности или повреждения, не пользуйтесь кроватью и уведомьте о них производителя.

5. Установка кровати

1. Освободите кровать от упаковки.
2. Проверьте кровать на предмет возможных повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
3. Внимательно прочитайте руководство пользователя.
4. Проверьте управление функциями кровати при помощи рычага.
5. Проверьте работу механизма блокировки колес.
6. Проверьте надежность боковых ограждений в поднятом положении.
7. Проверьте полноту комплектации, если были заказаны опции.

6. Положения кровати

Регулировка положений производится с помощью рычага в ножной секции кровати (см. п.9 иллюстрации «Кровать в деталях» на стр.5).
После регулировки секции, рукоятку необходимо сложить во избежание возможности получения травм или повреждения рукояток.

7. Спинки кровати и штанга двухопорная (рама Балканского)

Спинки кровати легко очищаемые, изготавливаются из металлических труб и ЛДСП.
Регулируются по высоте и оборудованы двухопорной штангой (рамой Балканского).
Рама Балканского регулируется по высоте и фиксируется в различных положениях на спинках кровати.






8. Колеса



У кровати 4 колеса, 2 их которых, расположенные по диагонали, оснащены тормозами.

При нажатии рычажка вниз колесо блокируется. Чтобы разблокировать колесо, нужно нажать на рычажок вверх.

	Нельзя перемещать кровать, если колеса заблокированы. Если нет необходимости передвигать кровать, колеса должны быть заблокированы, дабы снизить риск травмы пациента.

9. Боковые ограждения

Боковые ограждения вставные, быстросъемные, изготовлены из труб из нержавеющей стали и состоят из двух независимых друг от друга частей.

Чтобы отрегулировать высоту бокового ограждения, ослабьте барашек выставьте нужную высоту. Снова затяните барашек, чтобы зафиксировать боковое ограждение.

	Если пациент без сознания или не может встать, ограждения должны находиться в поднятом положении. Удостоверьтесь, что ограждения зафиксированы.

10. Очистка и дезинфекция

Очистка – это самое важное средство и требование для успешной химической дезинфекции. Когда кровать используется одним и тем же пациентом, рутинная очистка кровати весьма существенна для обеспечения гигиенической обстановки. Дезинфекция ходовой части необходима только в том случае, когда она видимо загрязнена инфекционными или потенциально инфекционными материалами (кровь, стул, гной) или, при инфекционной болезни, по указанию врача. Кровать должна быть протерта и продезинфицирована перед тем, как ее займет новый пациент!

Перед возобновлением пользования кроватью убедитесь в отсутствии остаточной влаги просушкой или продувкой деталей.

Чтобы максимально продлить срок службы кровати, следует обратить особое внимание на следующие рекомендации:

- Поверхность должна быть неповрежденной; любое повреждение должно быть устранено.
- Рекомендуется протирать влажной тканью. Чистящие вещества должны быть мягкими (неагрессивными к коже и поверхности) и экологически чистыми. Можно использовать бытовые очистительные средства.
- Для очистки металлических поверхностей с покрытием наилучшим средством является влажная мягкая ткань, увлажненная коммерческим бытовым очистителем.
- Для дезинфекции с помощью протирки следует применять дезинфицирующие средства, одобренные СЭС в рекомендованных концентрациях.

	При очистке кровати используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства. Не используйте чистящие вещества, которые могут привести к коррозии элементов кровати.

Примечание: дезинфицирующие средства на альдегидной основе имеют преимущество перед другими, поскольку у них широкий спектр воздействия, относительно низкий протеиновый эффект и экологическая безвредность. Главный недостаток таких агентов в том, что они могут оказаться аллергенами и раздражителями.

Средства на глюкопротаминовой основе не имеют этих недостатков, и столь же эффективны, однако стоят они относительно дороже.

Средства на хлорсодержащей основе приводят к коррозии металлов, синтетических материалов, резины и других материалов во время длительного применения или при слишком высоких концентрациях. Таким образом, такие вещества имеют более высокий так называемый протеиновый эффект, являются раздражителями слизистых оболочек и демонстрируют низкую экологическую совместимость.

11. Техническое обслуживание

Кровать спроектирована и сконструирована для применения в течение длительного времени. Срок ее службы при соблюдении правил эксплуатации оценивается от 2 до 8 лет в зависимости от условий и частоты применения.

Многократные перемещения, сборки и разборки, неправильное использование, а также длительное применение могут приводить к повреждениям, появлению дефектов и признаков износа, что может создавать опасность, если не устранять такие дефекты вовремя. В связи с этим необходимо каждые 6 месяцев производить визуальный осмотр изделия на возможное появление повреждений и ослабления конструкции кровати, так же необходимо производить протяжку всех болтовых соединений и смазку кровати.

Необходимо проинструктировать пользователей в нижеследующих правилах.

Необходимо производить минимальную визуальную проверку состояния и работоспособности кровати через частые регулярные промежутки времени и каждый раз перед повторным применением кровати.

	В случае подозрения на наличие повреждения или неисправности, кровать должна быть немедленно выведена из эксплуатации до ремонта или замены неисправных частей.

12. Комплект поставки:

- кровать – 1 шт.;
- эксплуатационная документация – 1 шт.

13. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель_____

Срок гарантии: _____12 месяцев_____

Дата продажи:_____ м.п.

Продавец: _____